



ТЕРМОИНДИКАТОР ПОРОГОВЫЙ **ОДНОРАЗОВЫЙ**

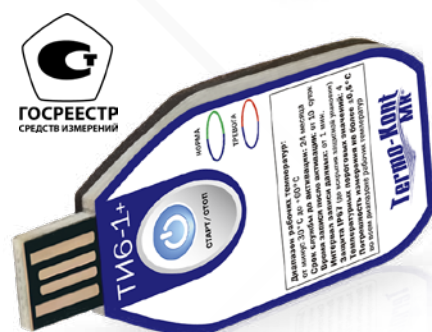

	TI6-1	TI6-1+
ОБЪЕМ ПАМЯТИ	8 640 данных (от 6 суток регистрации)	14 400 данных (от 10 суток регистрации)
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	-30°C ÷ +60°C	-30°C ÷ +60°C
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ	±0.5°C (-20°C ÷ +40°C) ± 1.0°C (в остальном)	±0.5°C (во всем диапазоне)
PDF-ОТЧЕТ	Защищенный на русском языке	Защищенный на русском / английском языке и CSV файл
ПАРОЛЬ	НЕТ	ДА
КОЛИЧЕСТВО ПОРОГОВ	4 температурных порога	
ИНТЕРВАЛ РЕГИСТРАЦИИ	1 мин. ~ 60 мин.	
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	ДА	
ЗАЩИТА	IP 67	

Защищенный от изменения данных PDF-отчет, который создается автоматически при подключении к USB-порту компьютера.
Индивидуальный номер каждого устройства, в том числе в PDF-отчете.

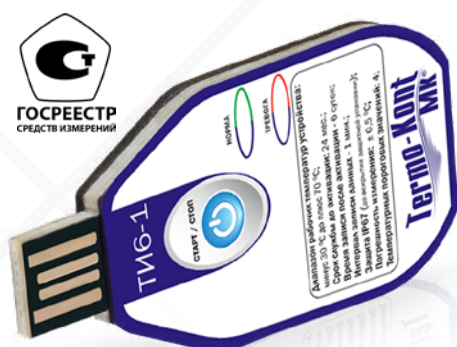

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕВОГА X

ID: TZ1904003835

Информация о файле

Дата создания файла: 18/09/19 07:13:42
Примечание: указанное в отчете время соответствует UTC+3:00 в 24-часовом формате времени [ДД:ММ:ГГ, ЧЧ:ММ:СС]

Информация об устройстве

Тип устройства: Термоиндикатор пороговый одноразовый ТИ6-1
Индивидуальный №: TZ1904003835
Отложенный старт: 5 мин
Режим работы: Регистратор температуры и времени
Версия прошивки: 2.10
Интервал регистрации: 1 мин

Журнал регистрации

Начало: 17/09/19 15:26:59
Остановка: 18/09/19 07:12:59
Количество данных: 947
Продолжительность: 00д 15ч 46м 00с
Способ остановки: Остановка при подключении к USB
Максимальная: 28.2°C
Минимальная: -17.7°C
МКТ: 25.0°C
Средняя: 22.5°C

Пороги	Условия	Момент нарушения	Время вне порога	Событий	Статус
H1: Выше +10.0°C	8 ч 40 м	Суммарно 18/09/19 00:06:59	00д 14ч 23м 00с	2	Тревога
H2: Выше +20.0°C	4 ч 20 м	Продолжительно 17/09/19 19:46:59	00д 13ч 59м 00с	2	Тревога
L1: Ниже +2.0°C	5 мин	Суммарно 18/09/19 05:30:59	00д 01ч 10м 00с	1	Тревога
L2: Ниже -10.0°C	10 мин	Продолжительно 18/09/19 05:54:59	00д 00ч 49м 00с	1	Тревога

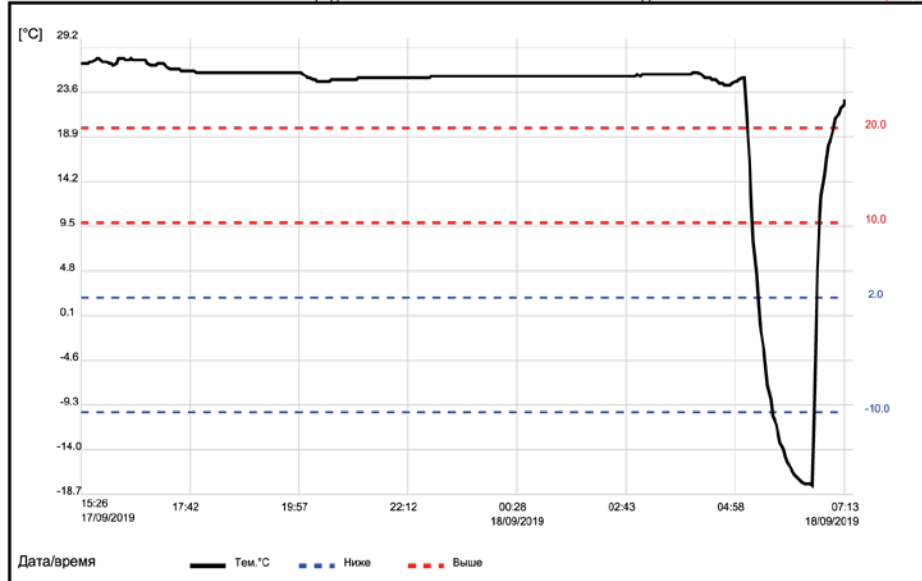


Таблица регистрации температуры по времени

Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C
17/09/2019	15:26:59	27.3	17/09/2019	17:02:59	27.2	17/09/2019	18:39:59	26.2	17/09/2019	20:14:59	25.3	17/09/2019	21:59:59	25.6	17/09/2019	23:26:59	25.7
17/09/2019	15:27:59	27.3	17/09/2019	17:03:59	27.3	17/09/2019	18:39:59	26.1	17/09/2019	20:15:59	25.3	17/09/2019	21:51:59	25.6	17/09/2019	23:27:59	25.7
17/09/2019	15:28:59	27.2	17/09/2019	17:04:59	27.3	17/09/2019	18:40:59	26.1	17/09/2019	20:16:59	25.2	17/09/2019	21:52:59	25.5	17/09/2019	23:28:59	25.7
17/09/2019	15:29:59	27.2	17/09/2019	17:05:59	27.3	17/09/2019	18:41:59	26.1	17/09/2019	20:17:59	25.2	17/09/2019	21:53:59	25.6	17/09/2019	23:29:59	25.8
17/09/2019	15:30:59	27.2	17/09/2019	17:06:59	27.3	17/09/2019	18:42:59	26.1	17/09/2019	20:18:59	25.1	17/09/2019	21:54:59	25.6	17/09/2019	23:30:59	25.8
17/09/2019	15:31:59	27.2	17/09/2019	17:07:59	27.4	17/09/2019	18:43:59	26.1	17/09/2019	20:19:59	25.0	17/09/2019	21:55:59	25.6	17/09/2019	23:31:59	25.8
17/09/2019	15:32:59	27.2	17/09/2019	17:08:59	27.4	17/09/2019	18:44:59	26.1	17/09/2019	20:20:59	25.0	17/09/2019	21:56:59	25.6	17/09/2019	23:32:59	25.8
17/09/2019	15:33:59	27.3	17/09/2019	17:09:59	27.2	17/09/2019	18:45:59	26.1	17/09/2019	20:21:59	25.0	17/09/2019	21:57:59	25.5	17/09/2019	23:33:59	25.8
17/09/2019	15:34:59	27.4	17/09/2019	17:10:59	27.0	17/09/2019	18:46:59	26.1	17/09/2019	20:22:59	25.0	17/09/2019	21:58:59	25.5	17/09/2019	23:34:59	25.8
17/09/2019	15:35:59	27.4	17/09/2019	17:11:59	27.0	17/09/2019	18:47:59	26.1	17/09/2019	20:23:59	25.0	17/09/2019	21:59:59	25.5	17/09/2019	23:35:59	25.8
17/09/2019	15:36:59	27.5	17/09/2019	17:12:59	26.9	17/09/2019	18:48:59	26.1	17/09/2019	20:24:59	25.0	17/09/2019	22:00:59	25.5	17/09/2019	23:36:59	25.8
17/09/2019	15:37:59	27.6	17/09/2019	17:13:59	26.9	17/09/2019	18:49:59	26.1	17/09/2019	20:25:59	25.0	17/09/2019	22:01:59	25.5	17/09/2019	23:37:59	25.8



Дата создания файла: 08-07-20 15:44:16

Termo-Kont MK

режим останки: USB

Примечание: указанное в отчете время соответствует UTC+3:00 24-часовом формате времени, [ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС]

Информация об устройстве

ID Устройства: U225000021
Тип устройства: Термоиндикатор пороговый одноразовый ТИ6-1+
Версия прошивки: V0.23
Версия устройства: U2MR21
Название Компании: Termo-Kont MK
Идентификатор отгрузки:
Начало регистрации: 17-06-20 10:24:03
Окончание регистрации: 08-07-20 15:44:16


Основная информация и настройки

Количество считываний: 11712
Макс. температура: 59.0°C (23-06-20 15:35:03)
Средняя температура: 6.9°C
Интервал записи: 1 мин
Отложенный старт: 5 мин
Мин. температура: -30.3°C (17-06-20 18:52:03)
МКТ: 5.4°C

Сводка по данным регистрации температуры

Температурные пороги	Контроль порога	Допустимое время	Общее время событий	Статус
H2:>15.0°C	Суммарно	1 мин	26313 мин	Тревога
H1:>8.0°C	Суммарно	1 мин	26374 мин	Тревога
L1:<-2.0°C	Суммарно	1 мин	4154 мин	Тревога
L2:<-2.0°C	Продолжительно	1 мин	4009 мин	Тревога

Журнал регистрации данных

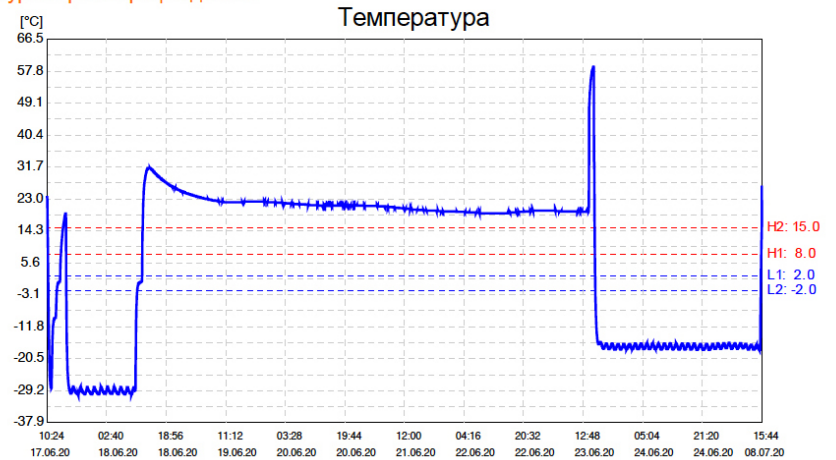

Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C	Дата	Время	°C
17-06-20	10:24:03	23.8	17-06-20	12:14:03	-10.1	17-06-20	14:04:03	5.3	17-06-20	15:54:03	-20.5	17-06-20	17:44:03	-28.6	17-06-20	19:34:03	-28.3
17-06-20	10:25:03	23.6	17-06-20	12:15:03	-10.0	17-06-20	14:05:03	5.6	17-06-20	15:55:03	-21.1	17-06-20	17:45:03	-28.6	17-06-20	19:35:03	-28.3
17-06-20	10:26:03	23.3	17-06-20	12:16:03	-10.0	17-06-20	14:06:03	6.1	17-06-20	15:56:03	-21.7	17-06-20	17:46:03	-28.6	17-06-20	19:36:03	-28.3
17-06-20	10:27:03	23.0	17-06-20	12:17:03	-9.9	17-06-20	14:07:03	6.5	17-06-20	15:57:03	-22.3	17-06-20	17:47:03	-28.7	17-06-20	19:37:03	-28.4
17-06-20	10:28:03	22.2	17-06-20	12:18:03	-9.8	17-06-20	14:08:03	6.9	17-06-20	15:58:03	-22.7	17-06-20	17:48:03	-28.8	17-06-20	19:38:03	-28.4
17-06-20	10:29:03	21.2	17-06-20	12:19:03	-9.8	17-06-20	14:09:03	7.3	17-06-20	15:59:03	-23.2	17-06-20	17:49:03	-28.8	17-06-20	19:39:03	-28.5
17-06-20	10:30:03	20.0	17-06-20	12:20:03	-9.8	17-06-20	14:10:03	7.6	17-06-20	16:00:03	-23.6	17-06-20	17:50:03	-28.8	17-06-20	19:40:03	-28.5
17-06-20	10:31:03	18.9	17-06-20	12:21:03	-9.7	17-06-20	14:11:03	8.0	17-06-20	16:01:03	-24.0	17-06-20	17:51:03	-28.9	17-06-20	19:41:03	-28.5
17-06-20	10:32:03	17.6	17-06-20	12:22:03	-9.6	17-06-20	14:12:03	8.3	17-06-20	16:02:03	-24.3	17-06-20	17:52:03	-28.9	17-06-20	19:42:03	-28.6
17-06-20	10:33:03	16.3	17-06-20	12:23:03	-9.6	17-06-20	14:13:03	8.6	17-06-20	16:03:03	-24.7	17-06-20	17:53:03	-29.0	17-06-20	19:43:03	-28.6
17-06-20	10:34:03	14.9	17-06-20	12:24:03	-9.6	17-06-20	14:14:03	8.9	17-06-20	16:04:03	-25.0	17-06-20	17:54:03	-29.0	17-06-20	19:44:03	-28.7
17-06-20	10:35:03	13.5	17-06-20	12:25:03	-9.6	17-06-20	14:15:03	9.2	17-06-20	16:05:03	-25.3	17-06-20	17:55:03	-29.1	17-06-20	19:45:03	-28.8
17-06-20	10:36:03	12.0	17-06-20	12:26:03	-9.6	17-06-20	14:16:03	9.5	17-06-20	16:06:03	-25.6	17-06-20	17:56:03	-29.1	17-06-20	19:46:03	-28.8
17-06-20	10:37:03	10.5	17-06-20	12:27:03	-9.5	17-06-20	14:17:03	9.8	17-06-20	16:07:03	-25.8	17-06-20	17:57:03	-29.1	17-06-20	19:47:03	-28.8
17-06-20	10:38:03	8.9	17-06-20	12:28:03	-9.5	17-06-20	14:18:03	10.0	17-06-20	16:08:03	-26.1	17-06-20	17:58:03	-29.1	17-06-20	19:48:03	-28.9
17-06-20	10:39:03	7.3	17-06-20	12:29:03	-9.5	17-06-20	14:19:03	10.3	17-06-20	16:09:03	-26.3	17-06-20	17:59:03	-29.2	17-06-20	19:49:03	-28.9
17-06-20	10:40:03	5.7	17-06-20	12:30:03	-9.5	17-06-20	14:20:03	10.5	17-06-20	16:10:03	-26.5	17-06-20	18:00:03	-29.3	17-06-20	19:50:03	-29.0
17-06-20	10:41:03	4.1	17-06-20	12:31:03	-9.5	17-06-20	14:21:03	10.8	17-06-20	16:11:03	-26.7	17-06-20	18:01:03	-29.3	17-06-20	19:51:03	-29.0